



Balatonföldvár Város Önkormányzata

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330, e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2024. november 27-én tartandó ülésére

Tárgya: Eszközbeszerzés laborba – klinikai kémiai automata

Előterjesztő: Holovits Huba polgármester

Előterjesztést készítette: Baumann Anita Gabriella vezető-főtanácsos

Tisztelt Képviselő – testület!

I. Előzmények

Dr. Kelemen Zoltán háziorvos kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben jelezte, hogy a balatonföldvári laborban működő kémiai automata beszerzési éve 2005. volt, az eszköz 20 éves üzemeltetési korát figyelembe véve műszakilag és eszmeileg is elavult, megfelelően működő kémiai automata nélkül a labor nem felel meg az ÁNTSZ minimum feltételeinek, ezért új eszköz beszerzése válik szükségessé.

II. A beszerzés értékének a meghatározása

A laborban végzett munkához a megfelelő paraméterekkel rendelkező klinikai kémiai automatára a nyár folyamán dr. Kelemen Zoltán háziorvos az önkormányzat nevében tájékozó jelleggel már kért be ajánlatokat, megkeresve az országban működő és szóba jöhető laboratóriumi, diagnosztikai eszközöket gyártó, illetve forgalmazó cégeket, akik az alábbi ajánlatokat tették:

1. DIALAB KFT (1151 Budapest, Bogáncs utca 8.)

nettó 13.250.000,-Ft + Áfa= **bruttó 16.827.500,-Ft**

részletfizetési lehetőségről nem nyilatkozott

2. Diagnosticum Zrt (1047 Budapest, Attila u.126)

nettó 10.660.000,-Ft + Áfa **bruttó 13.538.200,-Ft**

részletfizetési lehetőségről nem nyilatkozott

3. Orvostechnika Szerviz és Kereskedelmi Kft (1202 Budapest, Nagykőrösi út 187.)

nettó 12.350.000,-Ft + Áfa **bruttó 15.684.500,-Ft**

6 millió Ft előleg és az Áfa megfizetése után 36 havi részletfizetési lehetőség

A beszerzett előzetes ajánlatokból megállapítható, hogy a labor működéséhez szükséges klinikai kémiai automata beszerzése nem esik a közbeszerzési törvény a hatálya alá, ugyanis a 3 ajánlat átlaga az eszközbeszerzés közbeszerzési értékhatára (nettó 15 millió Ft) alatt van.

Az ajánlatok aktualizálása miatt 2024. novemberében megkerestük mindhárom ajánlatot adót, hogy nyilatkozzanak arról, hogy fenntartják-e ajánlatukat, illetve az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt nyilatkozatukat kértük arra vonatkozóan, hogy tudnak-e kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítani az eszköz megvásárlásához, ugyanis ez is az értékelési szempont része.

III. A legkedvezőbb ajánlat kiválasztása – az ajánlatok értékelése

Mindhárom orvostechnikai eszközök forgalmazásával foglalkozó cég megerősítte az ajánlatát, az alábbiak szerint:

Ajánlattevő cég	Megajánlott eszköz	Vételi ár	Garancia	Részletfizetési lehetőség	Ingyenes szolgáltatások
DIALAB KFT 1151 Budapest, Bogáncs utca 8. (www.dialab.hu) ajánlat érv.: 12-31.	URIT8120 klinikai kémiai automata	nettó 14.310.000,-Ft + Áfa bruttó 18.173.700,-Ft	12 hónap	nem áll módjukban biztosítani	üzembe helyezés, kiszállítás, kezelők betanítása
Diagnosticum Zrt 1047 Budapest, Attila u.126 (www.diagnosticum.hu) ajánlat érv.: 12.31.	BioLis 30i klinikai kémiai automata	nettó 10.660.000,-Ft + Áfa bruttó 13.538.200,-Ft	12 hónap	Kamatmentes részletfizetés alábbiak szerint: Futamidő: 12 hónap Első részlet: Áfa összege 2.878.200,-Ft További részletek: 969.091,-Ft 11 hónapon keresztül	szállítás, üzembe helyezés
Orvostechnika Szerviz és Kereskedelmi Kft 1202 Budapest, Nagykőrösi út 187. www.orvostechnika.eu ajánlat érv.: 01.20..	CA-640A klinikai kémiai automata	nettó 12.350.000,-Ft + Áfa bruttó 15.684.500,-Ft	24 hónap	Kamatmentes részletfizetés alábbiak szerint: Futamifő: 36 hónap <u>Első részlet, fizetendő üzembe helyezés után 8 munkanapon belül:</u> <u>5 350 000,- Ft + 3.334 500,- Ft Áfa</u> <u>Törlesztéssel fizetendő összeg: 7 000 000,- Ft</u> 35 hónapon keresztül fizetendő: 200 000,- Ft	üzembe helyezés, kiszállítás, kezelők betanítása

Az első körben is már a legdrágább ajánlatot adó Dialab Kft bruttó 1.346.200,-Ft-tal magasabb árat adott meg új ajánlatában, továbbá nyilatkozott, hogy részletfizetési lehetőséget nem tud adni. Garancia 12 hónap.

A **Diagnosticum Zrt** fenntartotta az ár vonatkozásában az ajánlatát és előleg fizetése nélkül, az Áfa befizetése után 12 havi kamatmentes részletfizetési lehetőséget ajánlott fel. Ajánlata az ár vonatkozásában a legkedvezőbb azonban csak 12 havi részletfizetési lehetőséget biztosít. Ez azt jelenti, hogy részletekben ugyan, de egy költségvetési éven belül ki kell fizetni a vételárat, 13.538.200,-Ft-ot. Garancia 12 hónap.

Orvostechnika Szerviz és Kereskedelmi Kft szintén fenntartotta ajánlatát, ami a második legkedvezőbb ajánlat az ár vonatkozásában, azonban 36 havi részletfizetési lehetőséget biztosít. Első évben ki kell fizetni 10.884.500,-Ft-ot, a 2. és 3. évben pedig 2.4 millió -2.4 millió forintot. Garancia 24 hónap.

Az árat, a részletfizetési lehetőség mértékét és a garancia hosszát figyelembe véve az ajánlatok sorrendje az alábbiak szerint alakul:

1. **Orvostechnika Szerviz és Kereskedelmi Kft**
nettó 12.350.000,-Ft + Áfa =bruttó **15.684.500,-Ft**
kamatmentes részletfizetési lehetőség 36 hónap
24 hó garancia
2. **Diagnosticum Zrt**
nettó 10.660.000,-Ft+ Áfa =bruttó **13.538.200,-Ft**
kamatmentes részletfizetési lehetőség 12 hónap
12 hó garancia
3. **Dialab Kft**
nettó 14.310.000,-Ft + Áfa = bruttó **18.173.700,-Ft**
kamatmentes részletfizetési lehetőség: nincs
12 hó garancia

Összességében a legkedvezőbb ajánlatot (2. legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat, 36 hónap részletfizetési lehetőség, 24 hónap garancia) az **Orvostechnika Szerviz és Kereskedelmi Kft (1202 Budapest, Nagykőrösi út 187)** nyújtotta be.

Döntési javaslat:

Javaslom a klinikai kémiai automatát az **Orvostechnika Szerviz és Kereskedelmi Kft-től megrendelni** ajánlatában szereplő áron és részletfizetési feltételek szerint.

Határozati-javaslat
...../2024. (.....) Kt határozat:
KLINIKAI KÉMIAI AUTOMATA BESZERZÉSE

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „**Klinikai kémiai automata beszerzése a laborba**” elnevezésű ajánlatkérésre bekért ajánlatok közül a legkedvezőbb, az **Orvostechnika Szerviz és Kereskedelmi Kft (1202 Budapest, Nagykőrösi út 187.)** által benyújtott **nettó 12.350.000,-Ft + Áfa =bruttó 15.684.500,-Ft** összegű ajánlatot, az ajánlatban szereplő kamatmentes részletfizetési lehetőség igénybevételével (első részlet fizetendő üzembe helyezés után 8 munkanapon belül: 5 350 000,- Ft + 3.334 500,- Ft Áfa, törlesztéssel fizetendő összeg: 7 000 000,- Ft, 35 hónapon keresztül fizetendő: 200 000,- Ft) elfogadja.

A kötelezettségvállaláshoz a fedezet az önkormányzat 2025. évi költségvetésében tervezésre kerül. A képviselő-testület felhatalmazza Holovits Huba polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Holovits Huba

Határidő: 2024. december 10. (a szerződés aláírására)

Balatonföldvár, 2024. november 21.

Holovits Huba sk
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 2024. november 21.

Ellenjegyezte:

dr. Törőcsik Gabriella
jegyző

Mellékletek:

1. Ajánlatok

Feladó: Dr. Kelemen Zoltán Károly Háziorvos

8623 Balatonföldvár, Szabadság tér 1.

Tárgy: Labor műszer beszerzés támogatása

Címzett: Balatonföldvár Város Polgármestere

8623 Balatonföldvár Petőfi Sándor u.1

Tisztelt Holovits Huba !

A Balatonföldvári labor műszer beszerzésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

A Prestige 24 kémia automata gép beszerzési éve 2005. Az eszköz 20 éves üzemelési korát figyelembe véve műszakilag és eszmeileg elavult.

Az ÁNTSZ minimum feltétel alapján a működési engedélye visszavonásra kerül.

Ezért kérjük a korábban megbeszélte gép beszerzésének támogatását.

Balatonföldvár, 2024.11.11

Tisztelettel:



Dr. Kelemen Zoltán Károly

Háziorvos

Tárgy: RE: Árajánlat aktualizása

Feladó: Spiesz János <janos.spiesz@dialab.hu>

Dátum: 2024.11.20. 9:59

Címzett: "'BTKT'" <munkacsoport@bfterseg.hu>

Tisztelt Kengyelicsné Fias Melinda!

Köszönettel vettük érdeklődését termékeink iránt.

Hivatkozva korábbi ajánlatkérésükre, mellékelten megküldöm Önnek **aktualizált árajánlatunkat**.

Részletfizetési lehetőséget nem áll módunkban biztosítani Önöknek.

Amennyiben további kérdése lenne az ajánlattal kapcsolatban készséggel állok rendelkezésére.

Tisztelettel:

Spiesz János

ügyvezető igazgató

Mobil: 30/961-4468

DIALAB KFT.

1151 Budapest

Bogáncs utca 8. BI 101 iroda.

Tel: 06-1/212-2505

Fax: 06-1/355-7370

janos.spiesz@dialab.hu

www.dialab.hu

From: BTKT <munkacsoport@bfterseg.hu>

Sent: Friday, November 15, 2024 10:07 AM

To: info@dialab.hu

Cc: Anita Baumann <preferens@balatonfoldvar.hu>

Subject: Árajánlat aktualizása

Tisztelt Ajánlattevő!

Köszönjük Balatonföldvár Város Önkormányzatának klinikai kémiai automata készülékre tett ajánlatukat. (Árajánlat hivatkozási száma: V-39/2024)

Az ajánlat aktualizálása miatt kérem, hogy nyilatkozzanak arról, hogy fenntartják-e ajánlatukat, illetve **nyilatkozatukat arra vonatkozóan is, hogy tudnak-e kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítani az eszköz megvásárlásához.**

Kérjük az aktualizált ajánlatot ismételten megküldeni.

Üdvözlettel:



LABORATÓRIUMI MŰSZEREK, ESZKÖZÖK
DIAGNOSZTIKUMOK
FORGALMAZÁSA ÉS SZERVIZE

DIALAB KFT.

1151 Budapest, Bogáncs utca 8. BI 101

Tel: 06 -1 / 212-25-05
Fax: 06 -1 / 355-73-70
e-mail: info@dialab.hu
Internet: www.dialab.hu

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár
Petőfi Sándor u. 1.
HOLOVITS HUBA Polgármester részére

TEL: 20/492-3440
E-mail: munkacsoport@bfterseg.hu
Önök h.sz.: 2024. 11. 20.
Tárgy: Ajánlat
Hiv. szám: V- 51/2024
Ügyintéző: Spiesz János Mobil: 30/961-4468

Tisztelt Holovits Huba Úr!

Köszönjük árajánlat kérésüket, amennyiben az ajánlatunk az Önök részére megfelelő és a legalacsonyabb összegű szolgáltatás tekintetében, abban az esetben élni kívánok hiánypótlási lehetőséggel.

Ajánlatunk:

Berendezés típusa: **URIT- 8120** kémiai automata
Származási ország: Kína
Szállítás: Raktárról azonnal, vagy 6-8 hét, a megrendelés megérkezése után.
Fizetés: Átutalással 15 napon belül a kiszállítást követően.

Nettó ár:	14 310 000,-
Áfa: 27%	3 863 700,-
Bruttó vételi ár:	18 173 700,-

Ingyenes szolgáltatások:
Üzembe helyezés,
kiszállítás,
kezelők betanítása,

Az ajánlott típusra 12 hónap garancia, érvényes.
A minőségbiztosítás érdekében német INSTANT által ajánlott kontrolokat használjuk

Műszaki paraméterek:

- 300 vizsgálat / óra,
- ionszelektív mérési lehetőség, /opció/
- reagens hűtött előtárolása,
- bár kódos azonosító rendszer,
- standard hely,
- sürgősségi pozíció,
- a vérvételi csőből történő mintavételezés,
- a mérések kvarc küvettában történnek,
- quality control és help programok,
- automatikus predilutáció.

Ajánlat érvényessége: 2024. december 31.

Reméljük ajánlatunk megnyeri tetszésüket és várjuk jelentkezésüket.

Tisztelettel:



Spiesz János
ügyvezető igazgató
30/961-44-68

DIALAB KFT.
H-1151 Budapest
Bogáncs u. 8. B1 101.
www.dialab.hu



QR kód: elérhetőségeimet
telefonra be tudja olvasni

2024. november 20.

E: BF/2024/17343

38/6240



LABORATÓRIUMI MŰSZEREK, ESZKÖZÖK
DIAGNOSZTIKUMOK
FORGALMAZÁSA ÉS SZERVIZE

DIALAB KFT. Balatonföldvári Közös

1151 Budapest, Bogáncs utca 8. Bt 101

Tel: 06 -1 / 242-25-05

Fax: 06 -1 / 355-73-70

e-mail: info@ dialab.hu

Internet: www.dialab.hu

Iktatószám

Balatonföldvári Közös
Önkormányzati Hivatal
8623 Balatonföldvár, Petőfi Sándor u. 1.

2024. SZEPTEMBER 09.

6240-4/2024

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár
Petőfi Sándor u. 1.
HOLOVITS HUBA Polgármester részére

TEL:
E-mail:
Önök h.sz: 2024. 08. 14.
Tárgy: Ajánlat
Hiv. szám: V- 39/2024
Ügyintéző: Spiesz János Mobil: 30/961-4468

Tisztelt Dr. Kelemen Zoltán Úr!

Köszönjük árajánlat kérésüket, amennyiben az ajánlatunk az Önök részére megfelelő és a legalacsonyabb összegű szolgáltatás tekintetében, abban az esetben élni kívánok hiánypótlási lehetőséggel.

Ajánlatunk:

Berendezés típusa: URIT- 8120 kémiai automata
Származási ország: Kína
Szállítás: Raktárról azonnal, vagy 6-8 hét, a megrendelés megérkezése után .
Fizetés: Átutalással 15 napon belül a kiszállítást követően.

Ár: 13 250 000,0 Ft
Áfa: 3 577 500,0 Ft
Vételi ár: 16 827 500,0 Ft

Ingyenes szolgáltatások:

Üzembe helyezés ,
kiszállítás,
kezelők betanítása,

ad

Az ajánlott típusra 12 hónap garancia, érvényes.

A minőségbiztosítás érdekében német INSTANT által ajánlott kontrolokat használjuk



2024. SZEPTEMBER 06.

KFM


Műszaki paraméterek:

- 300 vizsgálat / óra,
- ionszelektív mérési lehetőség, /opció/
- reagens hűtött előtárolása,
- bár kódos azonosító rendszer,
- standard hely,
- sürgősségi pozíció,
- a vérvételi csőből történő mintavételezés,
- a mérések kvarc küvettában történnek,
- quality control és help programok,
- automatikus predilutáció.

Ajánlatom érvényes: 2024. október 30.

Minden további kérdés tisztázásával, állok az Ön rendelkezésére.

Tisztelettel:



Spiesz János
ügyvezető igazgató
30/961-44-68

DIALAB KFT.
H-1151 Budapest
Bogács u. 8. BI 101.
www.dialab.hu



QR kód: elérhetőségeimet
telefonra be tudja olvasni

2024. augusztus 14.

URIT-8020

Paciens orientált klinikai kémiai automata

Japán minőség, Kínai gyártmány.




Klinikai kémiai automata

Forgalmazó: DIALAB Kft


Műszaki leírás

Mérési módszerek
Mérési elv
Fényforrás
Fotometriás mérési tartomány
Mért abszorbancia
Hullámhossz

Végpontos, Kinetikus, Fix idő , stb.
Fényelektromos, kolorimetriás.
Halogén lámpa 12V/20W
0-3.0 ABS
0.0005 Abs
8 hullámhossz szabadon választható.




Kapacitás
Memória kapacitás
Reagens tálca



Minta tálca
Reakció tálca
Minta mennyiség



Reagens mennyiség
Minimum reakció térfogat
Víz felhasználás
Mosófej
Kalibráció
Kontroll



Mérési hőmérséklet
Mérésismétlési képesség
Mintaátvitel
Hálózati feszültség
Környezeti előírások:

(340nm,405nm,492nm,510nm,546nm,578nm,630nm,700nm)

300 teszt/óra.
1000 mérés tárolása.
30 reagens pozíció.
Hűtött reagens tárolás.

45 pozíciókból vesz mintát.
120 reakciópozíció
3-80 μ L, 0.1 μ L -s lépésekben.
Reagens mennyiség érzékelés.
Automatikus mintavevő és reagens tú tisztítás.
Közös a reagens és mintavevő tű.

100-800 μ L, 1 μ L -s lépésekben.
180 μ L
2L/óra működés közben.
8-lépésben 5- mosószondával.
Line/non-line;multi-standard.
3 érték rendelhető mindegyik paraméterhez, QC görbe nyomtatható.

37.2°C.
<1.0%
<1.0%
AC220(1 \pm 10%)V,(50 \pm 1)Hz
Környezeti hőmérséklet 15-32°C
relatív páratartalom \leq 85%
légnyomás: 86-106 kPa

Tárgy: RE: Árajánlat megerősítése

Feladó: Füstös Ildikó <fustos.ildiko@diagnosticum.hu>

Dátum: 2024.11.18. 10:29

Címzett: BTKT <munkacsoport@bfterseg.hu>

CC: "preferens@balatonfoldvar.hu" <preferens@balatonfoldvar.hu>

Tisztelt Kengyelicsné Fias Melinda!

Kérésének megfelelően, mellékelten küldjük részletfizetési lehetőséggel kiegészített ajánlatunkat.

Amennyiben további kérése, kérdése lenne, készséggel állunk rendelkezésre.

Üdvözlettel:

Füstös Ildikó
közbeszerzési vezető

Diagnosticum Zrt.

Tel: +36-1/369-3684/109-es mellék

Fax: +36-1/369-4383

Mobil: +36-20/9675-203

From: BTKT <munkacsoport@bfterseg.hu>

Sent: Friday, November 15, 2024 10:11 AM

To: Füstös Ildikó <fustos.ildiko@diagnosticum.hu>

Cc: Anita Baumann <preferens@balatonfoldvar.hu>

Subject: Árajánlat megerősítése

Tisztelt Ajánlattevő!

Köszönjük Balatonföldvár Város Önkormányzatának klinikai kémiai automata készülékre tett ajánlatukat. (Árajánlat hivatkozási száma: FI 529/2024.)

Az ajánlat aktualizálása miatt kérem, hogy nyilatkozzanak arról, hogy fenntartják-e ajánlatukat, illetve **nyilatkozatukat arra vonatkozóan is, hogy tudnak-e kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítani az eszköz megvásárlásához.**

Kérjük az aktualizált ajánlatot ismételten megküldeni.

Üdvözlettel:

--

Kengyelicsné Fias Melinda
kistérségi ügyintéző

Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
06/20-492-3440
84/540-269; 84/540-270

Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás

Budapest, 2024. november 15.

Hivatkozási sz. FI 529a/2024.

Tárgy: Árajánlat

Kengyelicsné Fias Melinda
kistérségi ügyintéző

8623 Balatonföldvár
Petőfi u. 1.

Tisztelt Kengyelicsné Fias Melinda!

Köszönettel vettük érdeklődésüket, elektronikus levelére hivatkozva, az alábbi aktualizált ajánlatot adjuk:

BioLis 30i klinikai kémiai automata ISE modullal, 36 férőhelyes reagenstárcsával, reagens vonalkód leolvasóval és minta vonalkód leolvasóval	10.660.000,- Ft + ÁFA (27%)
---	-----------------------------

Gyártó: Tokyo Boeki Medisys Inc.

A megadott ár a szállítási-, vám- és üzembe helyezési költségeket tartalmazza, az ÁFA-t azonban nem. A megadott ÁFA-kulcs az adótörvény módosításával változhat, ebben az esetben a módosult ÁFA-kulcsot vesszük figyelembe.

A megadott nettó ár 2024. december 31-ig érvényes, amennyiben a HUF/JPY átváltási arány tartósan 3 HUF/JPY érték alatt marad.

Szállítási határidő: a megrendelést követő 5-12 héten belül.

Lehetőséget biztosítunk a készülékek kamatmentes részletekben történő kifizetésére, 12 hónap alatt.

Fizetési ütemezés az alábbiak szerint:

- Első részlet az ÁFA összege (2.878.200,-Ft), melynek fizetési határideje a számla kiállítását követő 30 nap.
- További részletek: 11 db egyenlő összegű (969.091,-Ft) befizetés, havi átutalással. Végző fizetési határidő: a készülék leszállítását követő 1 év.

A készülékre a DIAGNOSTICUM Zrt. 12 hónap garanciát vállal.

Kérjük, hogy a megrendelésen tüntessék fel az árajánlat hivatkozási számát, mert ennek hiányában a megrendelés beérkezésekor érvényes listaár kerül kiszámlázásra.


Amennyiben további kérése, kérdése lenne, készséggel állunk rendelkezésükre.

Megrendelésüket várva,
tisztelettel



Füstös Ildikó
közbeszerzési vezető

Diagnosticum Zrt.
1047 Budapest, Attila u. 126.
Adószám: 10824487-2-41



Váradi József
cégvezető


h

E: BF / 2024 / 11238



Diagnosticum Zrt.

alapítva 1989



Balatonföldvár Város Önkormányzata

Budapest, 2024. június 04.
Hivatkozási sz. FI 529/2024.
Tárgy: Árajánlat

Dr. Kelemen Zoltán

Balatonföldvár
Petőfi u. 1.
8623

Tisztelt Dr. Kelemen Zoltán!

Köszönettel vettük érdeklődésüket, az alábbi ajánlatot adjuk az általunk forgalmazott klinikai-kémiai automatára vonatkozólag:

**BioLis 30i klinikai kémiai automata ISE modullal, 36 férőhelyes reagenstárcsával,
reagens vonalkód leolvasóval és minta vonalkód leolvasóval 10.660.000,- Ft + ÁFA (27%)**

Gyártó: Tokyo Boeki Medisys Inc.

A megadott ár a szállítási-, vám- és üzembe helyezési költségeket tartalmazza, az ÁFA-t azonban nem. A megadott ÁFA-kulcs az adótörvény módosításával változhat, ebben az esetben a módosult ÁFA-kulcsot vesszük figyelembe.

A megadott nettó ár 2024. december 31-ig érvényes, amennyiben a HUF/JPY átváltási arány tartósan 3 HUF/JPY érték alatt marad.

Szállítási határidő: a megrendelést követő 4-10 héten belül.
Fizetési határidő: számla kézhezvételét követő 30 napon belül.

A készülékre a Diagnosticum Zrt. 12 hónap garanciát vállal.

Kérjük, hogy a megrendelésen tüntessék fel az árajánlat hivatkozási számát, mert ennek hiányában a megrendelés beérkezésekor érvényes listaár kerül kiszámlázásra.

Amennyiben további kérése, kérdése lenne, készséggel állunk rendelkezésükre.

Megrendelésüket várva,
tisztelettel

Füstös Ildikó
közbeszerzési vezető

Diagnosticum Zrt.
1047 Budapest, Attila u. 126.
Adószám: 10824487-2-41

Váradi József
cégvezető



el: 6240/2024

KFM

W

Tárgy: Árajánlat aktualizálása

Feladó: <kaltenecker@orvostechnika.eu>

Dátum: 2024.11.20. 17:59

Címzett: <munkacsoport@bfterseg.hu>

Tisztelt Kengyelicsné Fias Melinda!

Kistérségi ügyintéző részére

Köszönjük, hogy megtisztelt levelével.

Az aktualizált ajánlatot mellékelem. Az árajánlatot továbbra is érvényesnek tartom. A fizetési feltételek között leírtam a kamatmentes fizetési változatot.

Üdvözlettel!

A MAGYAR készülék és reagens gyártó!



Kaltenecker Antal
ügyvezető igazgató

Orvostechnika Kft.

Alapítva: 1991

H-1202 Budapest

Nagykőrösi út 187.

Phone: +36 1 285 46 15

Mobilphone: +36 30 9426 222

Skype: kaltenecker9

www.orvostechnika.eu

Mellékletek:

Balatonföldvár CA-640A aktualizált.pdf

243 KB

Balatonföldvár Város Önkormányzata

8623 Balatonföldvár Petőfi u. 1

Tárgy: Árajánlat (készült 2 oldalon)

száma: 20240301

Árajánlat adó:

Orvostechnikai Szerviz és Kereskedelmi Kft.

Adószám: 10615674-2-43
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-079763
Hosszú név: Orvostechnikai Szerviz és Kereskedelmi Kft.
Telephely: H- 1202 Budapest, Nagykörösi út 187.
Telefon: +36 1 285 4615
e-mail : kaltenecker@orvostechnika.eu
www.orvostechnika.eu

Tisztelt Dr. Kelemen Zoltán Úr!

Köszönöm, hogy megtisztelt árajánlat kérésével.

Vállalatunk 1991-ben alakult. Fő tevékenységünk laboratóriumi készülékek fejlesztése, gyártása, kereskedelme és szervizelése, valamint a szükséges fogyóanyagok szállítása. Az ajánlatban szereplő CA-640A klinikai készüléket automatát, mint a termék magyarországi kizárólagos forgalmazója, szervize és képviselője ajánljuk megvételre. A berendezés rendelkezik CE minősítéssel, megfelel a vonatkozó Európai Unió szabályoknak és irányelveknek.

1. CA-640A klinikai kémiai automata készüléket:

Műszaki paraméterek/szakmai jellemzők: Klinikai kémiai automata.

Mérési módszerek	Végpontos, Kinetikus, Fix idő , stb.
Mérési elv	Fényelektromos, kolorimetriás.
Fényforrás	Halogén lámpa 12V/35W
Fotometriás mérési tartomány	-05-6.0 ABS
Mért abszorbancia	0.0005 Abs
Hullámhossz	

1. Automatikus újra hígítás kóros minta esetén.
2. Kétirányú LIS/HIS számítógépes kapcsolat.
3. Latex reagensek ismételt keverése megvalósítható, nincs ülepedésből eredő mérési hiba.
4. Windows kezelői felület.
5. Kettős hulladéktárolás környezetvédelmi szempontok szerint.
6. A küveták mosása detergenssel és melegített vízzel történik automatikusan, alacsony vízfogyasztás..

7. Automatikus küvetta tisztasági ellenőrzés, nincs háttérhiba mérés.
8. Hűtött reagens tároló, osztható cikkekkel, két reagens metodika nem tolja el a pozíciót.
9. Reagens mennyiség visszajelzés.
10. Run monitorozás. A működés minden ciklusa követhető a monitoron.
11. C program. A minőség-ellenőrzés többféle módon megvalósított.
12. Kalibrálási görbe megjelenítése monitoron és printerre.
13. Sürgősségi paciens mérési lehetőség.
14. Kevés vegyszerigény min. 150 ul.
15. Bárkódos mintaazonosítás.
16. A készülék nyílt rendszerű. A különféle reagensek szabadon használhatók
17. STAT sürgősségi minta mérési lehetőség

Kapacitása :

640 Teszt/ óra ISE- vel 860 Teszt / óra

Állagra történő megállapítás:

A készülék új, gyártási év 2023.

Ajánlott berendezés típusa:

CA- 640A klinikai kémiai analizátor.

VTSZ :

9018

Szállítási határidő:

A megrendeléstől számított maximum 4-6 hét.

Garancia:

Üzembe helyezéstől számítva 24 hónap

A garancia csak az ORVOTECHNIKAI Kft. álltól forgalmazott reagensek felhasználása esetén érvényes!

Garancia viselője: _____

Orvostechnikai Kft

Ár:

Nettó egység ár:

12 350 000,- Ft

Áfa: mértéke 27%

3 334 500,- Ft

Bruttó egységi ár:

15 684 500,- Ft

Mennyiség:

1 db

Bruttó ár összesen:

15 684 500,- Ft

Fizetési feltételek:

1.Átutalással:

Az üzembe helyezést és a betanítást követően 10 munkanapon belül kérjük az összeget átutalni.

2.Kamatmentes törlesztéssel: Futamidő: 36 hónap.

Első részlet, fizetendő üzembe helyezés után 8 munkanapon belül:

5 350 000,- Ft + 3.334 500,- Ft Áfa

Törlesztéssel fizetendő összeg: 7 000 000,- Ft

35 hónapon keresztül fizetendő: 200 000,- Ft

Ingyenes szolgáltatások:

Ügyintézés, betanítás kiszállítás, üzembe helyezés.

Melléklet: Részletező információs lapokat mellékeltem

Minden további kérdés tisztázására állok az Ön rendelkezésére.

Érvényesség: 2025.01.30

Köszönettel

2024.11.20

Kaltenecker Antal
igazgató

E: BT / 2024 / 7901

OrvosTechnika


Alapítva: 1991

Orvostechnika Szerviz és Kereskedelmi Kft.

H-1202 Budapest Nagykörösi út 187.

Tel : 00 36 1 285 46 15 Fax : 00 36 1 286 40 50

vevoszolgalat@orvostechnika.eu www.orvostechnika.eu



Balatonföldvár Város Önkormányzata

8623 Balatonföldvár Petőfi u. 1

Tárgy: Árajánlat (készült 2 oldalon)

száma: 20240301

Árajánlat adó:

Orvostechnikai Szerviz és Kereskedelmi Kft.

Adószám: 10615674-2-43
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-079763
Hosszú név: Orvostechnikai Szerviz és Kereskedelmi Kft.
Telephely: H- 1202 Budapest, Nagykörösi út 187.
Telefon: +36 1 285 4615
e-mail : kaltenecker@orvostechnika.eu
www.orvostechnika.eu

Tisztelt Dr. Kelemen Zoltán Úr!

Köszönöm, hogy megtisztelt árajánlat kérésével.


Vállalatunk 1991-ben alakult. Fő tevékenységünk laboratóriumi készülékek fejlesztése, gyártása, kereskedelme és szervizelése, valamint a szükséges fogyóanyagok szállítása. Az ajánlatban szereplő CA-640A klinikai készüléket automatát, mint a termék magyarországi kizárólagos forgalmazója, szervize és képviselte ajánljuk megvételre. A berendezés rendelkezik CE minősítéssel, megfelel a vonatkozó Európai Unió szabályoknak és irányelveknek.

1. CA-640A klinikai kémiai automata készüléket:

Műszaki paraméterek/szakmai jellemzők: Klinikai kémiai automata.

Mérési módszerek	Végpontos, Kinetikus, Fix idő , stb.
Mérési elv	Fényelektromos, kolorimetriás.
Fényforrás	Halogén lámpa 12V/35W
Fotometriás mérési tartomány	-05-6.0 ABS
Mért abszorbancia	0.0005 Abs
Hullámhossz	

1. Automatikus újra hígítás kóros minta esetén.
2. Kétirányú LIS/HIS számítógépes kapcsolat.
3. Latex reagensek ismételt keverése megvalósítható, nincs ülepedésből eredő mérési hiba.
4. Windows kezelői felület.
5. Kettős hulladékátrolás környezetvédelmi szempontok szerint.
6. A küveták mosása detergenssel és melegített vízzel történik automatikusan, alacsony vízfogyasztás..



7. Automatikus küvetta tisztasági ellenőrzés, nincs háttérhiba mérés.
8. Hűtött reagens tároló, osztható cikkekkel, két reagens metodika nem tolja el a pozíciót.
9. Reagens mennyiség visszajelzés.
10. Run monitorozás. A működés minden ciklusa követhető a monitoron.
11. C program. A minőség-ellenőrzés többféle módon megvalósított.
12. Kalibrálási görbe megjelenítése monitoron és printerre.
13. Sürgősségi paciens mérési lehetőség.
14. Kevés vegyszerigény min. 150 ul.
15. Bárkódos mintaazonosítás.
16. A készülék nyílt rendszerű. A különféle reagensek szabadon használhatók
17. STAT sürgősségi minta mérési lehetőség

Kapacitása :

640 Teszt/ óra ISE- vel 860 Teszt / óra

Állagra történő megállapítás:

A készülék új, gyártási év 2023.

Ajánlott berendezés típusa:

CA- 640A klinikai kémiai analízátor.

VTSZ :

9018

Szállítási határidő:

A megrendeléstől számított maximum 4-6 hét.

Garancia:

Üzembe helyezéstől számítva 24 hónap

A garancia csak az ORVOTECHNIKAI Kft. álltól forgalmazott reagensek felhasználása esetén érvényes!

Garancia viselője:

Orvostechnikai Kft

Ár:

Nettó egység ár:

12 350 000,- Ft

Áfa: mértéke 27%

3 334 500,- Ft

Bruttó egységi ár:

15 684 500,- Ft

Mennyiség:

1 db

Bruttó ár összesen:

15 684 500,- Ft

Fizetési feltételek:

Átutalással:

Az üzembe helyezést és a betanítást követően 10 munkanapon belül kérjük átutalni.

Ingyenes szolgáltatások:

Ügyintézés, betanítás kiszállítás.

Melléklet: Részletező információs lapokat mellékeltem

Minden további kérdés tisztázására állok az Ön rendelkezésére.

Köszönettel

2024.03.01

Kaltenecker Antal
igazgató

**Orvos
Technika**
1122 Budapest, Károlyi utca 187

Kaltenecker Antal

Balatonföldvár Város Önkormányzata
Holovits Huba polgármester
8623 Balatonföldvár
Petőfi utca 1.
+36 84 540 330

Iktatószám: 160

Szerződés ajánlat
Kamatmentes részletfizetés.

Készülék megnevezése:	CA-640A Klinikai kémiai automata		
Típus:	Klinikai kémiai automata		
Készülék nettó vételi ára:	12 350 000 Ft		
Áfa	3 334 500 Ft	Hitel összege	6 350 000 Ft
Bruttó ár	15 684 500 Ft	Futamidő:	36
Előleg:	6 000 000 Ft	Havi törlesztés	176 389 Ft
Üzembe helyezéskor fizetendő:	Első részlet + a teljes vételi ár Áfa-ja		9 510 885 Ft

1. A törlesztés minden hónap 15.-ig teljesítendő. Amennyiben a kifizetés a vevő hibájából megszakad a berendezés az Orvostechnika Kft. tulajdonába visszakerül. A visszavásárlás összege a már kifizetett összeg 30%-a.
2. Az üzembe helyezést, a kiszállítást és a kezelők betanítását térítésmentesen elvégezzük.
3. A készülék 24 hónapig garanciális. A szakszerűtlen beavatkozásból származó meghibásodás esetén a javítást leszámoljuk.
4. Amennyiben ajánlatom az Ön részére megfelelő, kérem annak elfogadását aláírással igazolni és **1 példányt visszaküldeni.**
5. A berendezést, az aláírást követő 90 napon belül kiszállítjuk az előre egyeztetett időpontban.

Tisztelettel

Kaltenecker Antal

OrvosTechnika Kft.
Orvostechnikai Szervíz és Kereskedelmi Kft.
1202 Budapest, Nagykörösi út 187.
Adószám: 10615674-2-43

A vevő elfogadó nyilatkozata: **1db aláírt példányt szíveskedjék visszaküldeni.**

Az Orvostechnika Kft. ajánlatát elfogadom és ezt aláírással igazolom, kérem a berendezés és reagensek kiszállítását.

Tartozékok:


2024. hó. nap '

Dátum.

Holovits Huba polgármester

ORVOSTECHNIKAI Kft.

Paciens orientált klinikai kémiai automata
Japán minőség, Kínai gyártmány.



CA-640A

Klinikai kémiai automata

CA-640A

Forgalmazó: OrvosTechnikai Kft


Műszaki leírás: CA-640A

Kapacitás: 640 Teszt/óra ISE-vel 860 Teszt/óra

Használhatóság, gazdaságosság:



A mérendő mintákat nem kell külön szérumtartó edényekbe áttölteni a vérvételi cső mintatárolásra és a méréshez is használható.





Carryover védelem / minták közötti átvitel védelem / a mintavevő tűk mosogatásával.

Tű dugulás elleni védelem és vészjelző



- 120 db UV stabil. Hosszú élettartamú küvetta.
- Elektronikus reagenstér fűtés.
- Minimális reagens igény 150 µl.

- 8 fejes kűvetta mosó 10 lépésben.
- Mosás detergenssel és melegvízzel.




Nagy pontosságú optikai rendszer.
Stabil hosszúéletű halogén lámpa A fotó elektromos érzékelőrendszer teljesítménye a következő:

Optionális hullámhosszok:

- 340 nm, 405 nm, 450 nm, 480 nm, 505 nm, 546 nm, 570 nm, 605 nm, 660 nm, 700 nm, 750 nm, 800 nm
 - Hullámhosszok pontossága: ± 1 nm
 - Az abszorbancia mérési tartománya: $-0,5 \sim 6,0$
 - Felbontási arány: 0,0001
- Fényforrás: halogén lámpa, 12V/20W

1. Automatikus újra hígítás kóros minta esetén.
2. Kétirányú LIS/HIS számítógépes kapcsolat.
3. Latex reagensek ismételt keverése megvalósítható, nincs ülepedésből eredő mérési hiba.
4. Windows kezelői felület.
5. Kettős hulladéktárolás környezetvédelmi szempontok szerint.
6. A kűvetták mosása detergenssel és melegített vízzel történik automatikusan, alacsony vízfogyasztás..
7. Automatikus kűvetta tisztasági ellenőrzés, nincs háttérhiba mérés.
8. Hűtött reagens tároló, osztható cikkekkel, két reagens metodika nem tolja el a pozíciót.
9. Reagens mennyiség visszajelzés.
10. Run monitorozás. A működés minden ciklusa követhető a monitoron.
11. C program. A minőség-ellenőrzés többféle módon megvalósított.
12. Kalibrálási görbe megjelenítése monitoron és printerre.
13. Sürgősségi paciens mérési lehetőség.
14. Kevés vegyszerigény min. 150 ul.
15. Bárkódos mintaazonosítás.
16. A készülék nyílt rendszerű. A különféle reagentek szabadon használhatók
17. STAT sürgősségi minta mérési lehetőség.

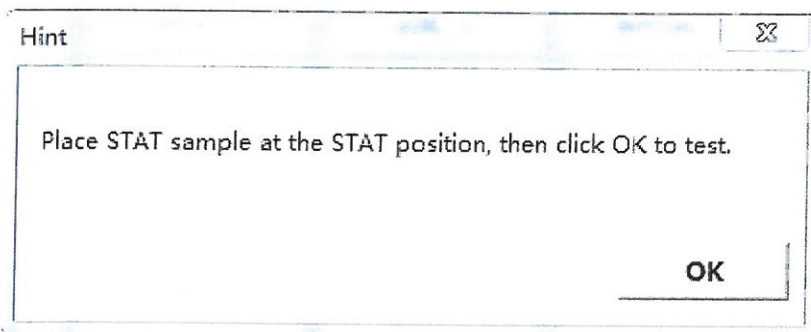

Minta és reagens tárolás:

- 2 db reagens tray . 160 reagens pozícióval

- 1 db mintatároló egy körben 99 minta behelyezésével.
- Reagensok hűtve 2-8 °C fokon tárolható.

Opcionális egységek:

Az opcionális egységek nem részei az alap készüléknek.

Az ügyfelek igényeinek megfelelően választják ki az opcionális modulokat.

A készüléke négy választható modult támogat az alábbiak szerint:

- ISE modul
- Minta vonalkód-leolvasó rendszer
- Reagens vonalkód-leolvasó rendszer
- Tűdugulást észlelő modul.

Hígítás:

Kétreagenses metodikák nem csökkentik a mérhető metodikák számát, a reagenstároló ívek megoszthatóak.

A mérés fix speciális műanyag küvettába történik.

Reagens minimálisan : 150 ul

Szérum mennyiség min.: 2 ul

Mérés:

Paraméterek:	klinikai kémia, kinetikus, végpontos, többpontos, ION szelektív, immunológia, bichromatikus
Hőmérséklet:	37C+/- 0,1C
Hullámhossz tartomány:	340-800nm optikai ráccsal.
Linearitás:	-0,5 ~ 6,0
Fényforrás:	halogén lámpa 2000 üzemóra élettartammal

Adatkezelés:

Az analizátor egy számítógéphez csatlakozik itt az adat eltárolódik saját printerével is nyomtatható, vagy központi gépre küldhető.

Kétirányú LIS/HIS kapcsolat.

Szerviz szempontok:

Stabil mechanika, jól hozzáférhető.

Megbízható, könnyen javítható modul rendszerű elektronika.

Gyártó: URIT Medical Kína